SIMCRO™

2mLプレミアム

フォーワードセレクタブル5基
イントラナサルノズル付

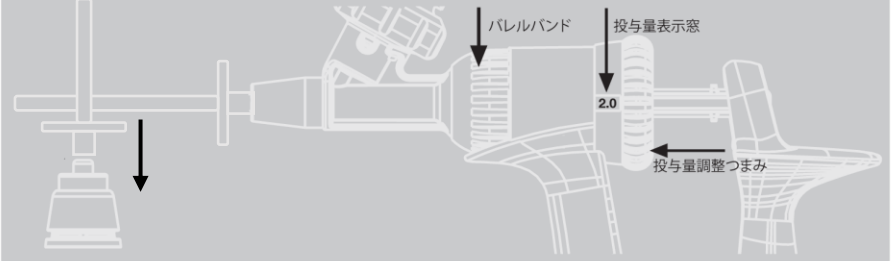

イントラナサルノズルの取り付け
ニードルハブにイントラナサルノズルを差し込み、しっかりと固定してください。
イントラナサルノズルの取り外し
まっすぐに引いて取り外してください。

注意
イントラナサルノズルはディスポーザブルであり、再使用しないでください。

フォーワードセレクタブルの使用方法
①ご希望の容量を設定してください。
②バレル内に空気が入らないようにするため、イントラナサルノズル側が少し上向きになるように投与器を保持し、ワクチン（ティーエスブイ２あるいはティーエスブイ３）吸入部分がつねにワクチン液レベルの下になるようにします。
③投与器ハンドルを１回握って放すとワクチン液がバレル内に充填されます。
④投与器を数回握ると、バレルの前方からバレル内の空気を取り除くことができます。

重要
斜めに投与する場合は、投与器を握ったまま保持し、投与器が真っ直ぐになった状態で投与器のハンドルを回すようにし、バレル内に空気が入らないようにご注意ください。

使用中にうまく充填されない場合
①ワクチンボトルが正しく取り付けられているか確認してください。
②ワクチンボトルを取り外し、投与器を温水に浸した状態でハンドルを何度か強く握り、内部の汚れや詰まりを洗い流してください。

潤滑油の注入
使用中にハンドルが重くなってきたら、バレルバンドを緩めてバレルを取り外し、プランジャーの**O**リングにオリーブオイルまたは植物オイルをさしてください。

メンテナンス
毎回、使用後すぐに投与器をきれいな水で洗ってください。

消毒
消毒剤を使用するか、もしくはバレルを煮沸消毒します。
（消毒可能なのはニードルハブとバレルとゴムパッキンのみ）
消毒剤は、ハロゲン塩製剤を除き、すべての消毒剤の使用が可能です。ただし、消毒後、直ちにきれいな水でよく洗ってください。
バレルバンドを緩めて投与器本体からバレルを外したら、バレルからボトルホルダーを取り外し、バレルを煮沸水中で５分間、煮沸してください。煮沸後は、バレルが冷めてから投与器に取り付けるようにしてください。

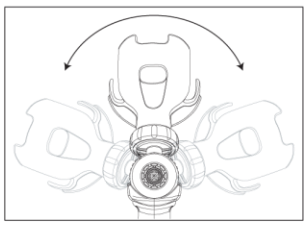

使用前にバレルバンドを緩めることにより、バレル（投与筒）の位置を調節することができます。使いやすい角度に固定することが可能です。

重要：投与量の調整方法
投与量調整つまみを回す前に投与器のハンドルを握ってください。ご希望の投与量が投与量表示窓に出るまで、調節つまみを時計回りまたは半時計回りに回してください。（下図）
ご希望の投与量を選択された後、投与器のハンドルを放してください。







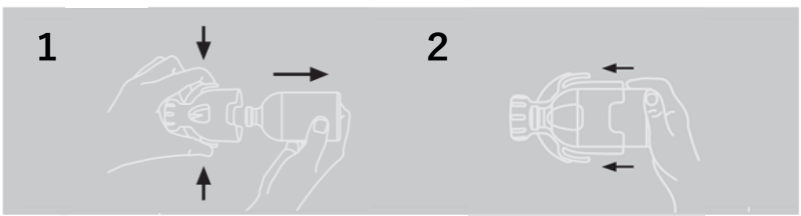

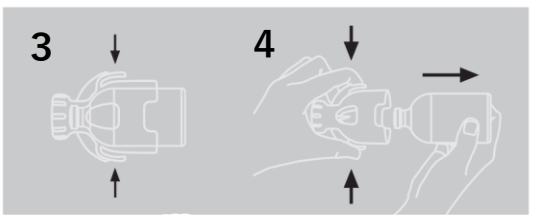

①ワクチンボトルのゴム栓とワクチン吸入部分が確実に合うように、ワクチンボトルホルダーに挿入します。このとき、ワクチン液の漏れを防ぐため、投与器を逆さにして、下からボトルを装着してください。

②「カチッ」と音がするまで、ワクチンボトルをしっかり押し込んでください。

③使用後、ワクチンボトルを取り外す際は、固定つまみを内側に押してください。

④固定つまみを押したまま、ワクチンボトルを引いてください。

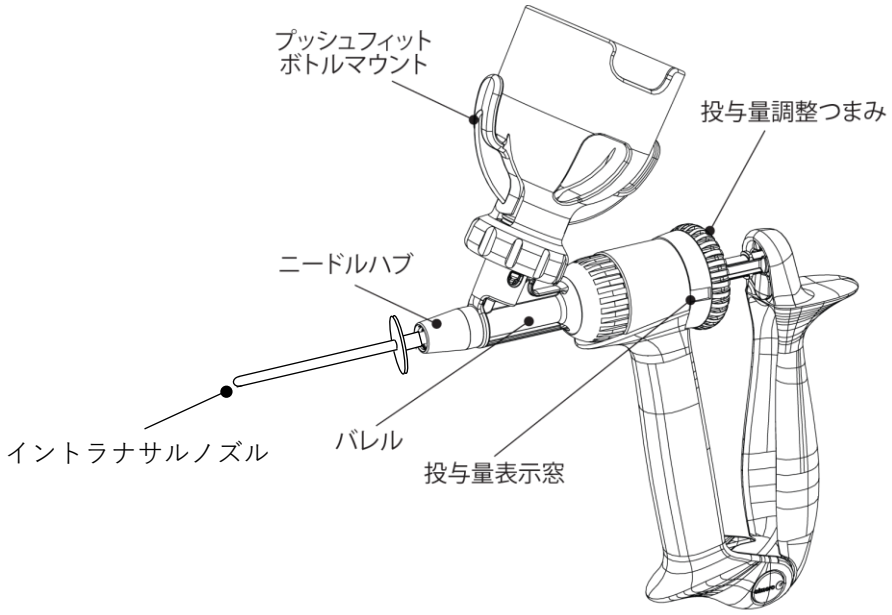

ITVGN Rev A

PARTNER.
INNOVATE.
DELIVER.

Manufactured by:
Simcro Limited
6 Latham Court
Hamilton 3204
New Zealand

TEL +64 7 846 7723
FAX +64 7 846 7738
EMAIL deliver@simcro.com
WWW.simcro.com

SIMCRO™

SIMCRO™

2mLプレミアム

フォーワードセレクタブル 5基
イントラナサルノズル付

Simcro is ISO 9001 Certified. All products are engineered for animal welfare, operator safety, treatment efficacy, and ease of use.

SIMCRO™